




RADIOMETRO DIRETTO ELIOFANOMETRO/DIRECT RADIOMETER AND SUNSHINE SENSOR

- Code DPD503 : USCITE/OUTPUTS:Sig1 RAD.DIRETTA/DIRECT RADIATION 0..1500W/m²
Sig2 INSOLAZIONE SI/NO-SUNSHINE STATUS ON/OFF TTL
ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 12Vdc
- Code DPD504 : USCITE/OUTPUTS:Sig1 RAD.DIRETTA/DIRECT RADIATION 60..300mV 0..1500W/m²
Sig2 INSOLAZIONE SI/NO-SUNSHINE STATUS ON/OFF TTL
ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY 12Vdc

SCHEMA DI CONNESSIONE PER M/R-Log
M/R-Log CONNECTION

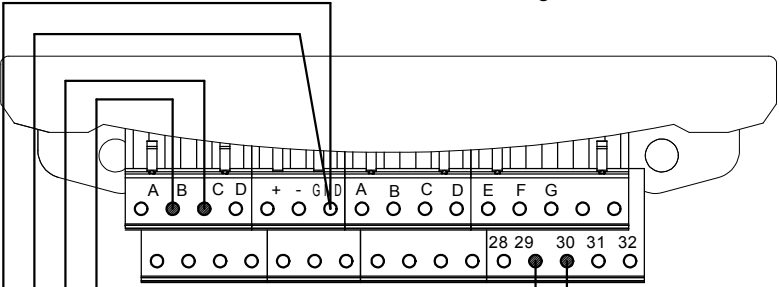


SCHEMA DI CONNESSIONE PER E-Log
E-Log CONNECTION

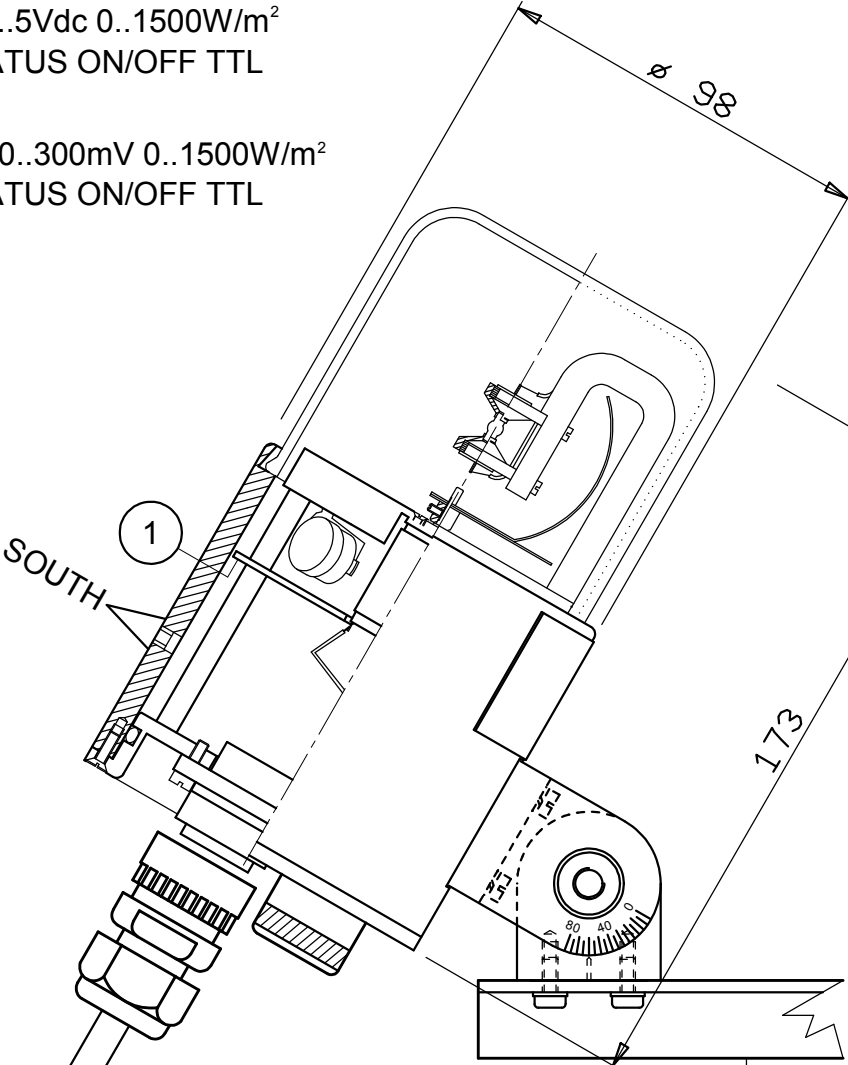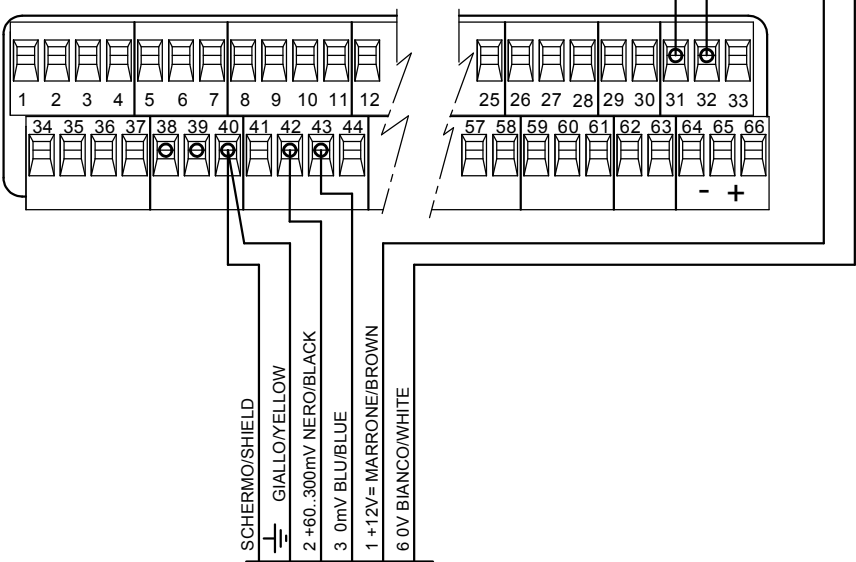


SUPPORT DYA041

CABLES Code DWA5..

****** La buona efficacia del sistema anticondensa richiede una alimentazione ininterrotta.
Well functioning of anti-condensation system requires a nonstop power supply.

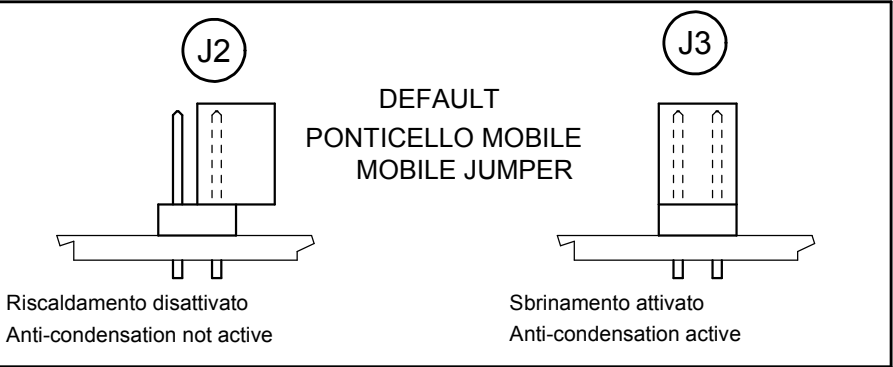

- J3** ponticello sbrinamento
defrosting mobile jumper
- J2** ponticello riscaldamento
heater mobile jumper

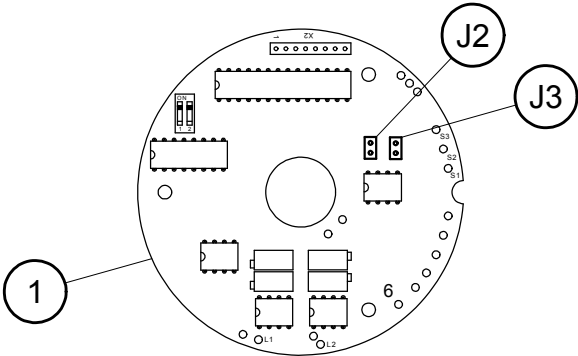

Pin	
1	+12 Vdc ALIMENTAZIONE/POWER SUPPUPPLY
2	+Sig1 (vedi targhetta/see label) RADIAZIONE DIRETTA/DIR. RADIATION
3	-Sig1Sig2 COMUNE/COMMON
4	+Sig2 TTL 0-5V STATO ELIOFANIA/ SUNSHINE
5	Schermo Screen
6	0Vdc COMUNE ALIM./POW.SUPPLY & RISCALDAMENTO/HEATER
7	CONTENITORE/ARMATURE

f	12-03-14	A.A.	E.C.	CGC	L.L.	Modificato attacco a palo
e	10-12-12	A.A.	E.C.	CGC	A.As.	Inserito indicazione di connessione
d	19-04-07	A.A.	B.K.	CGC	A.As.	Inserito indicazione di connessione a data logger LSI e nota ** (RNC 32/07)
c	02-05-06	A.A.	B.K.	CGC	A.As.	Eliminato scheda alimentatore eliminato articolo 24Vca cod.dpd501
b	27-06-03	A.A.	CGC	C.F.	C.F.	AGGIORNAMENTO GENERALE PROGETTO 13-03
Origine	26-06-95	A.A.				Descrizione della revisione
Esp.di revisione	Data	(R)	(C)	(V)	(A)	
			Scala:			Codice:
			Descrizione/Description: RADIOMETRO DIRETTO ELIOFANOMETRO DIRECT RADIOMETER AND SUNSHINE SENSOR		Disegno/Drwg.: DISACC3698f	N.di pag.