CARATTERISICHE TECNICHE/SPECIFICATIONS

SONDA ALETTATA STAGNA IN OTTONE PER APPLICAZIONI FISSE IN CELLE FRIGORIFERE ED AMBIENTI ANCHE SEVERI FISSAGGIO A PARETE.

WALL-MOUNTED WATERPROOF SLATTED BRASS PROBE FOR STATIONARY APPLICATIONS IN COOLER AND EVEN HOT ENVIRONMENTS.

ELEMENTO SENSIBILE/SENSIBLE ELEM.	Pt100 NORME IEC751
ACCURATEZZA/ACCURACY	DLE120: 1/3 DIN DLE121: CLASS B EST105: CLASS A
TEMPO DI RISPOSTA/RESONSE TIME	3 min
TEMP. OPERATIVA/OPERATING TEMP.	-50+80° C

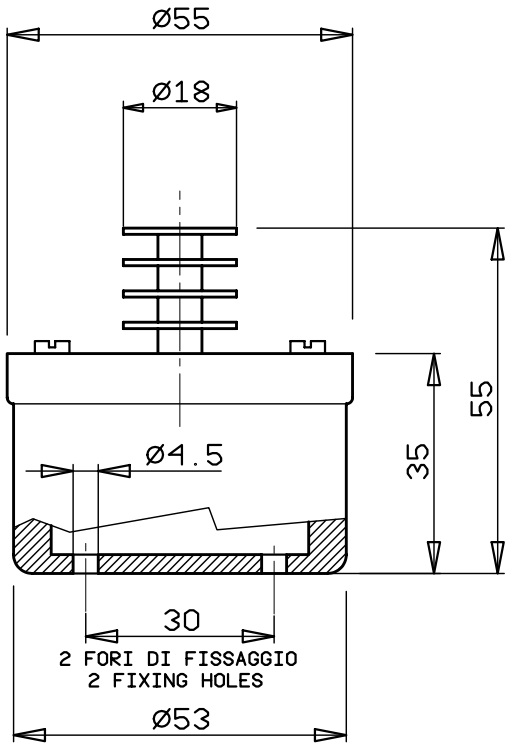

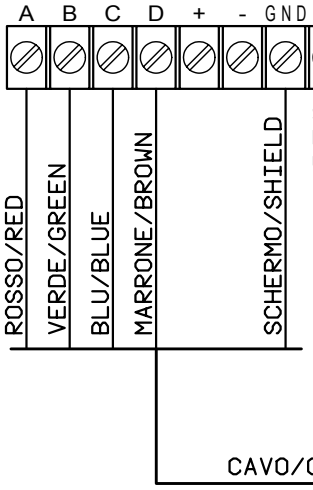

SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log
GENERIC ELECTRICAL CONNECTION TO E/R/M-Log DATA LOGGER
MORSETTIERA/TERMINAL BOARD
VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER
SEE DATA LOGGER USER'S MANUAL

VARIANTE EST105

SPINA MINI-DIN 7 POLI PER DATALOGGER E/R/M-Log
7 CONTACTS MINI-DIN PLUG FOR DATALOGGER



VARIANTE DLE120/121

MN1025 CAVO OPZIONALE/OPTIONAL CABLE

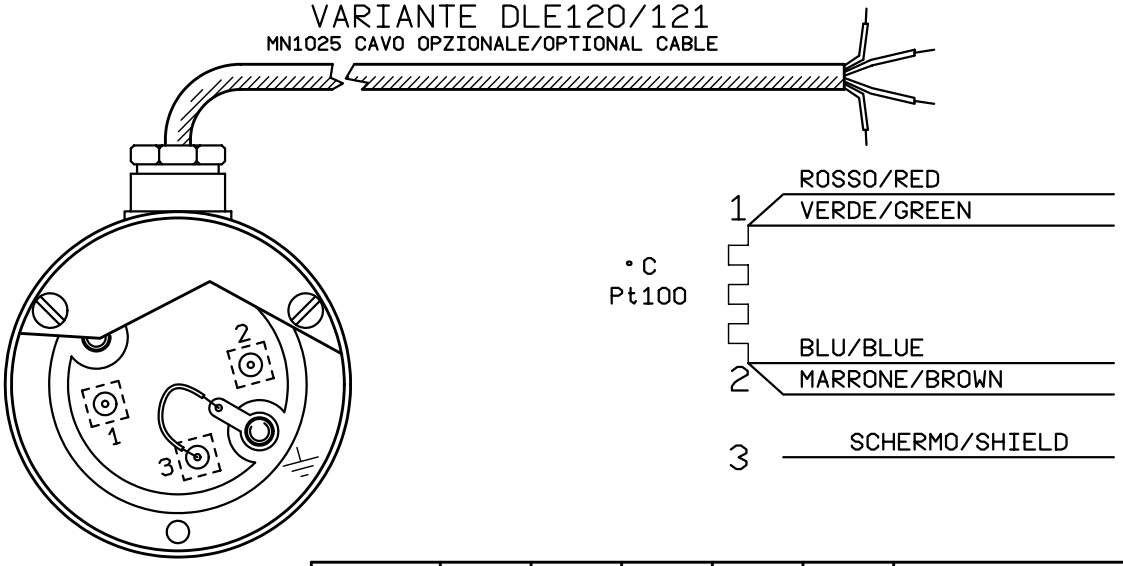

Esp.di revisione	Data	(R)	(C)	(V)	(A)	Materiale:
d	31-03-11	A.A.	CGC	CGC	A.AS.	Aggiornato collegamento a datalogger
c	27-06-06	A.A.	B.K.	CGC	A.AS.	Modificato colori dei fili del cavo(MN1025) di uscita
b	27-06-06	A.A.	B.K.	CGC	A.AS.	Aggiunto collegamenti a BABUC ed E-Log
a	28-06-00	A.A.	B.K.	CGC	C.F	Aggiunto morsetto n°3
Origine	04-02-99	A.A.	CGC	CGC	A.AS.	Descrizione della revisione

Scala:

Codice: EST105 DLE120 DLE121

Disegno: DISACC4332d

Descrizione:

FOGLIO ACCOMPAGNATORIO
SONDA PER RILIEVI AERO-TERMICI
AERO-THERMAL PROBE MEASURES

N.di pag.